





Asennusopas

RadiForce® MX215

Värinestekidenäyttö

TURVAMERKINNÄT

Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.

 VAROITUS VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja seurauksena syntyvä tilanne voi olla hengenvaarallinen.	 HUOMAA HUOMAA-merkinnän huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa kohtalaisia henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja tai johtaa tuotteen vahingoittumiseen.
 Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa.	 Ilmoittaa pakollisen toimenpiteen, jota on noudatettava.

TURVATOIMET

VAROITUS


Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa.

Käytä laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa, ja liitä laite normaaliin pistorasiaan.

Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja käyttöjännitteen vastaavuus. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

"Virtalähde: 100-120/200-240 Vac 50/60 Hz"

 **Älä päästä laitteeseen pieniä esineitä tai nesteitä.**

Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat pienet esineet tai nesteroiskeet voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos laitteen sisään pääsee esine tai nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

 **Käytä laitetta asianmukaisessa paikassa.**

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai laitteiston vahingoittuminen.


- Älä sijoita ulkoilmaan.
- Älä sijoita kuljetusjärjestelmään (mm. alus, lentokone, juna tai auto).
- Älä sijoita pölyiseen tai kosteaan ympäristöön.
- Älä sijoita paikkaan, jossa näyttöön voi roiskua vettä (kuten kylpyhuoneeseen tai keittiöön).
- Älä sijoita paikkaan, jossa näyttö tulee välittömästi kosketuksiin höyryn kanssa.
- Älä sijoita lähelle lämmön tai kosteuden lähettä.
- Älä sijoita paikkaan, jossa voi olla syttyviä kaasuja.

 **Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.**

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

Taustavalon loistelamput sisältävät elohopeaa (tuotteet, joissa on LED-taustavalolamput eivät sisällä elohopeaa). Hävitä ne paikallisten, osavaltion tai liittovaltion määräysten mukaan.

HUOMAA

 **Älä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.**


- Älä aseta esineitä ilmastointiaukkojen päälle.
- Älä asenna laitetta suljettuun tilaan.
- Älä käytä laitetta makuulle asetettuna tai ylösalaisin.

Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen.

 **Käytä helposti luokse päästävissä olevaa pistorasiaa.**

Näin ongelmatilanteissa virta voidaan katkaista nopeasti.

Varoitusilmoituksen sijainti

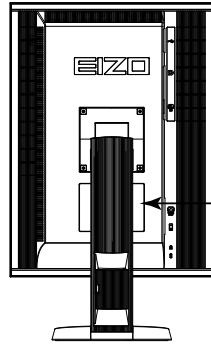



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIER.

ACHTUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

小心
有触电的风险。请勿打开。

警告
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Yhteensopivat tarkkuudet

Näyttölaite tukee seuraavia tarkkuuksia.

√ : Tuettu







Analoginen tulo (DVI-I)

Tarkkuus	Soveltuvat signaalit	pystytaajuus	Dot Clock	Pystynäyttö	Vaakanäyttö
640 × 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (Max.)	√	√
640 × 480	Macintosh	67 Hz		√	√
640 × 480	VESA	~ 75 Hz		√	√
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz		√	√
800 × 600	VESA	60 Hz		√	√
800 × 600	VESA	~ 75 Hz		√	√
832 × 624	Macintosh	75 Hz		√	√
1024 × 768	VESA	60 Hz		√	√
1024 × 768	VESA	~ 75 Hz		√	√
1152 × 864	VESA	75 Hz		√	√
1152 × 870	Macintosh	75 Hz		√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		√	-
1280 × 960	VESA	60 Hz		-	√
1280 × 960	Macintosh	75 Hz		-	√
1280 × 1024	VESA	~ 75 Hz		-	√
1600 × 1200	VESA	60 Hz		-	√

Digitaalinen tulo (DVI-I / DisplayPort)

Tarkkuus	Soveltuvat signaalit	pystytaajuus	Dot Clock	Pystynäyttö	Vaakanäyttö
640 × 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (Max.)	√	√
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz		√	√
800 × 600	VESA	60 Hz		√	√
1024 × 768	VESA	60 Hz		√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		√	-
1280 × 960	VESA	60 Hz		-	√
1280 × 1024	VESA	60 Hz		-	√
1600 × 1200	VESA	60 Hz		-	√

Yksikön merkinnät


Merkintä	Merkinnän merkitys
	Päävirtakytkin: Sammuta näytön päävirta painamalla tätä.
	Päävirtakytkin: Käynnistä näytön päävirta painamalla tätä.
	Virtapainike: Käynnistä tai sammuta näyttö koskettamalla tätä.
	Vaihtovirta
	Varoitus sähköiskuvaarasta
	HUOMAA: Katso tämän käyttöoppaan SAFETY SYMBOLS (TURVAMERKINNÄT) ja PRECAUTIONS (VAROTOIMENPITEET) kohta.

Pakkauksen sisältö


Tarkasta, että kaikki seuraavassa mainitut kohteet löytyvät pakkauksesta. Mikäli nimikkeitä puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Huomautus

- Säilytä pakkaus ja materiaalit vastaista käyttöä ja näytön siirtämistä varten.
 - Näyttö
 - Virtajohto
 - USB -kaapeli: UU300
 - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Asennusopas (käsillä oleva opas)
 - PRECAUTIONS (VAROTOIMET)
- Digitaalinen signaalikaapeli: DisplayPort - DisplayPort (PP300)
- Digitaalinen signaalikaapeli: DVI-D - DVI-D (DD300)



Säädöt ja toiminnot

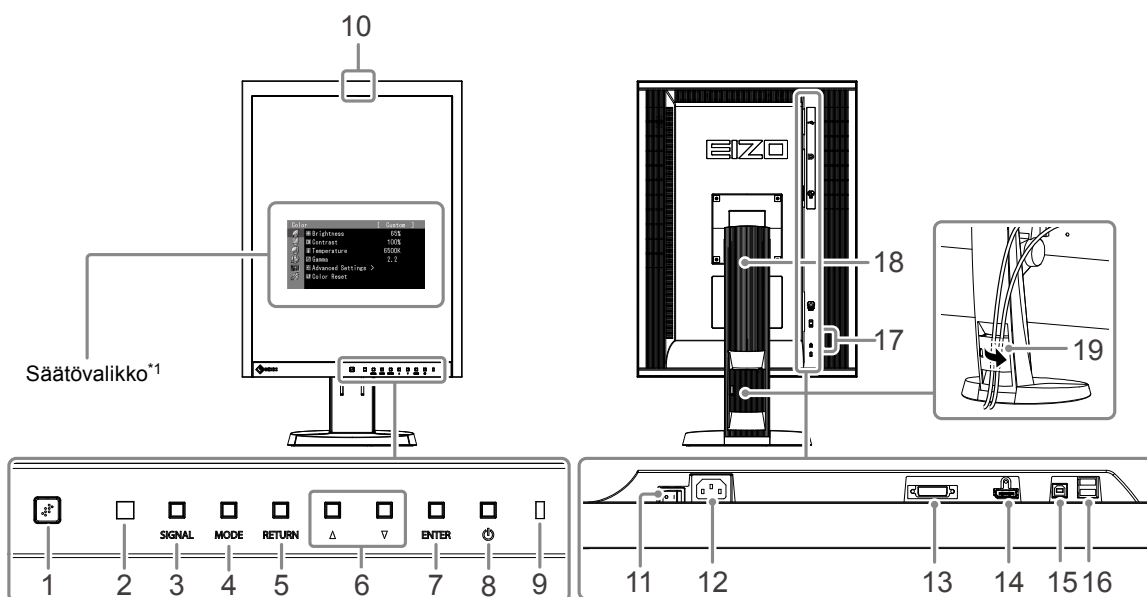

1. Presence Sensor (Liiketunnistussensori)	Tunnistaa henkilön liikkeen näytön edessä.
2. Ympäristövalon sensori	Käytetään RadiCS/RadiCS LE:n valoisuusasteen muuttamisen valvontatoimintoa varten. Katso lisätietoja RadiCS/RadiCS LE -Käyttöoppaasta (CD-ROM).
3. SIGNAL painike	Vaihtaa näytön tulosignaali.
4. MODE painike	Vaihtaa CAL-Switch tila.
5. RETURN painike	Peruuttaa asetuksen/säädön ja sulkee säätövalikon.
6. ▲▼ painike	Mahdollistaa valikon valinnan sekä toimintojen säädön ja asetuksen.
7. ENTER painike	Näyttää säätövalikon, valitsee valikkonäytön komennon ja tallentaa säädetyt arvot.
8. ⏻ painike	Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
9. Virran merkkivalo	Ilmoittaa näytön toimintatilan. Vihreä: Toiminta, Oranssi: Virransäästötila, Pois päältä: Päävirta/virta katkaistu
10. Sisäänrakennettu etuanturi (diatyyppi)	Käytetään kalibrointiin ja Grayscale Check (Harmaa skaala tarkistus) -tarkistuksen tekoon.
11. Päävirtakytkin	Päävirran kytkeminen ja katkaiseminen.
12. Virtaliitin	Liitä virtajohto tähän.
13. Tulosignaaliiliitäntä	DVI-I-liitäntä
14. Tulosignaaliiliitäntä	DisplayPort-liitäntä
15. USB upstream -portti	Liitä USB-yhteyttä käyttävän ohjelmiston tai USB-keskittimen käytön edellyttämä USB-kaapeli tähän.
16. USB downstream -portti	Liittää USB-ohelilaitteen.
17. Turvalukon paikka	Yhdenmukainen Kensington MicroSaver -turvajärjestelmän kanssa.
18. Teline	Käytetään näytön korkeuden ja kallistuskulman säätämiseen.
19. Kaapelinpidin	Peittää näytön kaapelit.

*1 Katso käyttöohjeet Käyttöoppaasta (CD-ROM).

Liitoskaapelit

Huomio

- Varmista, että näyttö ja PC ovat sammutettuja.
- Kun vaihdat nykyisen näytön tähän näyttöön, vaihda PC:n tarkkuusasetus ja kuvaruudun virkistystaajuus tämän näytön mukaisiksi. Katso yhteensopiva tarkkuus takakannen taulukosta ennen PC:hen liittämistä

Huomautus

- Jos liität laitteeseen useita PC-laitteita, katso ohjeita Käyttöoppaasta (CD-ROM).


1. Käännä näyttöä 90° vastapäivään.

Vaakanäyttöasento on näytön oletusasento. Käännä näyttöä 90 astetta pystyasentoon ennen asentamista.

2. Liitä signaalikaapelit tulosignaaliiliitäntöihin ja PC:hen.


Tarkasta liittimien muoto ja liitä kaapelit.

Kiristä liittimien ruuvit signaalikaapelin liittimien liittämisen jälkeen.

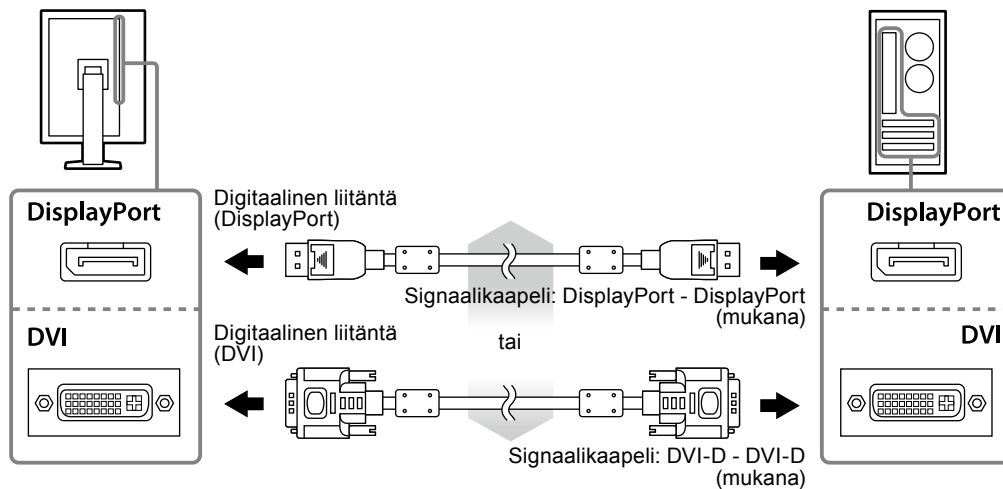

3. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin näyttöön.

4. Liitä USB-kaapeli, jos käytät RadiCS LE- tai ScreenManager Pro for Medical -ohjelmistoa.



5. Käynnistä näyttö painamalla .

Näytön virran merkkivalo syttyy vihreänä.

6. Käynnistä PC.

Näyttöön ilmestyy kuva.


Jos näyttöön ei tule kuvaa, katso kohta ”Ei kuvaa” (sivu 7).

Huomio

- Sammuta näyttölaite ja PC käytön jälkeen.
- Suurin virransäästö saavutetaan katkaisemalla virta virtapainikkeesta. Virran katkaisimen päävirtakytkimellä tai virtajohdon irrottaminen sulkee täysin virran syötön näyttöön.

Näytön korkeuden ja kulman säätäminen

Pidä kiinni näytön reunoista ja säädä näytön korkeus sekä kallistus- ja kiertokulma työskentelyn kannalta sopiviksi.

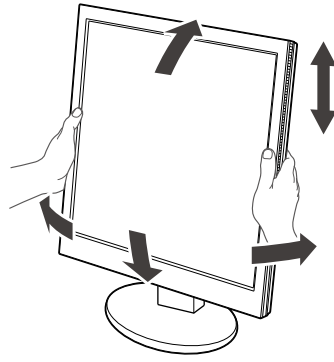


Huomio

- Varmista, että kaapelit on liitetty oikein.

Painikeoppaan näyttäminen

Etupaneelin näppäimien painaminen (☰-näppäintä lukuun ottamatta) avaa kyseisen painikkeen yläpuolelle painikeoppaan.

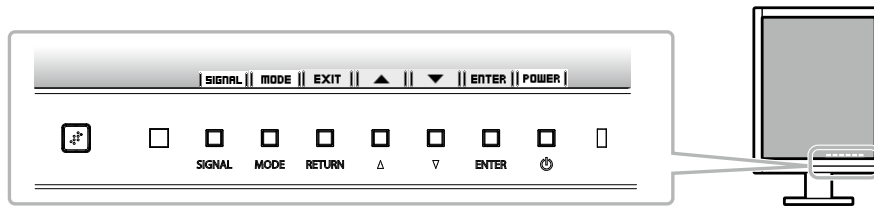

Huomautus


- Painikeopas näkyy säätövalikon tai tilavalikon ollessa avoinna.
- Painikeopas näkyy eri tavoin valitun valikon tai tilan mukaan.

Näyttötilan valitseminen

Tämä toiminto mahdollistaa helpon halutun tilan valinnan näytön käyttötarkoituksen mukaan.

√: Kalibrointi on käytettävissä.

Tila	Tarkoitus	
1-DICOM	Sopii kuvien esittämiseen DICOM-tilassa.	√
2-Custom	Voit valita asetuksen mieltymystesi mukaan.	√
3-CAL	Näyttää kalibrointiohjelmiston säätämän näytön.	√
4-Text	Sopii mm. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentakäyttöön.	-

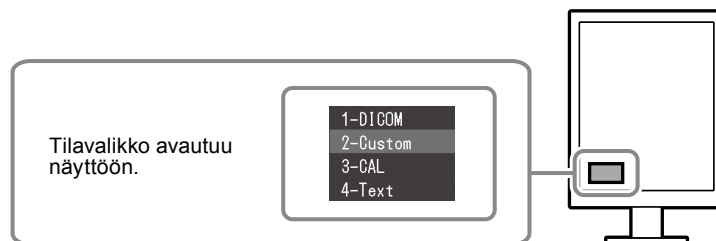


Toimenpiteet

1. Paina MODE.

Tilavalikko näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.

2. Luettelon tila näkyy korostettuna aina kun MODE painetaan.

Tilavalikon ollessa avoinna tilaa voidaan vaihtaa ▲- tai ▼-painikkeella.



Näytön laadunvalvonta

Näytön mukana toimitetaan laadunvalvontaohjelmisto ”RadiCS LE” (Windows-tietokoneille).

Asenna RadiCS LE RadiCS LE -käyttöoppaan (CD-ROM) ohjeiden mukaan näytön kalibrointia ja kalibrointihistorian hallintaa varten. Tee RadiCS SelfQC -toiminnon ja sisäänrakennetun etusensorin avulla määräajoin tehtävä kalibrointi ja Grayscale Check (Harmaa skaala tarkistus) -tarkistus. Katso lisätietoja Käyttöoppaasta (CD-ROM).

Huomio


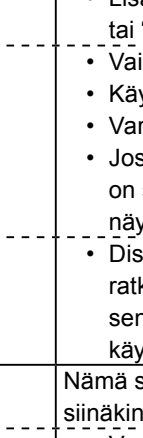
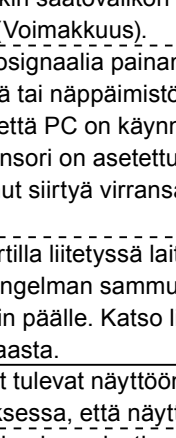
- Liitä näyttö PC:hen USB-kaapelilla, jos käytät RadiCS LE -ohjelmistoa.

Huomautus

- Käytä valinnaisena saatavaa näytön laadunvalvontaan tarkoitettua ”RadiCS UX1” -ohjelmistopakkausta, jos haluat käyttää lääkinällisten standardien mukaista täsmällistä laadunvalvontaa.

Ei kuvaa

Jos ongelma ei korjaannu ehdotetuilla toimenpiteillä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
1. Ei kuvaa <ul style="list-style-type: none">Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.Kytke virta päälle päävirtakytkimestä.Paina .Katkaise päävirta ja kytke se jälleen takaisin parin minuutin kuluttua.
<ul style="list-style-type: none">Virran merkkivalo palaa vihreänä.	<ul style="list-style-type: none">Lisää kutakin säätövalikon arvoa "Brightness" (Kirkkaus) tai "Gain" (Voimakkuus).
<ul style="list-style-type: none">Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none">Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL -näppäintä.Käytä hiirtä tai näppäimistöä.Varmista, että PC on käynnissä.Jos liikesensori on asetettu tilaan "On" (päällä), näyttö on saattanut siirtyä virransäätötilaan. Siirry lähemmäksi näyttöä.
<ul style="list-style-type: none">Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja vihreänä.	<ul style="list-style-type: none">DisplayPortilla liitettyssä laitteessa on ongelma. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla näytön ja kytkemällä sen takaisin päälle. Katso lisätietoja ulostulolaitteen käyttöoppaasta.
2. Alla oleva sanoma tulee näyttöön.	Nämä sanomat tulevat näyttöön, kun signaalin syöttö on väärä siinäkin tapauksessa, että näyttölaite toimii moitteettomasti.
<ul style="list-style-type: none">Nämä sanomat tulevat näyttöön, kun tulosignaalia ei ole. Esimerkki: 	<ul style="list-style-type: none">Vasemmalla oleva viesti voi tulla näkyviin, koska kaikki PC:t eivät lähetä signaalia heti virran kytkemisen jälkeen.Varmista, että PC on käynnissä.Tarkista, onko signaalikaapeli liitetty asianmukaisesti.Vaihda tulosignaalia painamalla SIGNAL -näppäintä.
<ul style="list-style-type: none">Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella. Esimerkki: 	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusvaatimuksia (katso "Yhteensopivat tarkkuudet").Käynnistä PC uudelleen.Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näytönohjaimen käyttöoppaasta.
fD: Dot clock fH: Vaakataajuus fV: Pystytaajuus	

Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tiedonhakupöytäkirjaan tai lähettää missään muodossa eikä millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muilla menetelmillä käyttäen ilman EIZO Corporation kirjallista lupaa. EIZO Corporation on kaikin mahdollisin tavoin pyrkinyt varmistamaan, että käyttöoppaan tiedot ovat ajan tasalla, mutta EIZO-näyttöjen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

- Tuotteen tekniset ominaisuudet voivat vaihdella alueittain. Tarkista tekniset ominaisuudet ostoalueen kielen mukaisesta käyttöoppaasta.
- On varmistettava, että lopullinen järjestelmä on IEC60601-1-1-vaatimusten mukainen.
- Sähkövirralla toimivat laitteet voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat vaikuttaa näyttöön, rajoittaa sen toimintaa tai vahingoittaa näyttöä. Asenna laitteet valvottuun tilaan, jossa tällaiset vaikutukset voidaan välttää.

